

- Utilizzarne su cutte integre.
 - Se presenta ferite proteggere come da indiscordanze mediche.
 - Non utilizzarle in casi di ustura, rotura o nora integrità del materiale.
 - La controllazione e le istruzioni fanno parte del dispositivo medico.
 - Per evitare danni possibili perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo del bambinato.
 - Non procedere a modificare la struttura del dispositivo medico escludere ogni responsabilità.
 - La modifica/alterazione del dispositivo medico esclude ogni responsabilità.
 - Per evitare danni possibili perdita di funzionalità del prodotto o una limitata durata dello stesso si consiglia di prevenire/limitare il contatto tra il dispositivo del bambinato.
 - Non utilizzare in modo da non portare alcuna funzionalità del prodotto.
 - Non MD in modo da non portare alcuna funzionalità del prodotto.
 - Non procedere a modificare le regolazioni effettuate dal medico o tecnico ortopedico come, oli, liquori o sostanze grasse o acide.
 - Non procedere a modificare la struttura del dispositivo medico o tecnicamente.
 - Il tutele prevede come accessorio il dispositivo CO-730 avente la barbante FGP srl.

AVVERTENZE D'USO

CONTROINDICAZIONI: al momento, nessuna nota. La corretta applicazione, secondo le puntuali indicazioni fornite dal medico curante o del tecnico ortopedico, non dà logo a controindicazioni. **APPLICAZIONE:** solo per adulti.

CONTRO INDICAZIONI: al momento nessuna nota | a corretta applicazione



avvenute riportate nelle medico curanti, che romano parte integrante delle stesse. Per ogni operazione si presenti istruzione, in combinata con quelle fornite dal tecnico o per le persone problematica insorta in conseguenza dell'uso del dispositivo protesico. Per ogni procedura immediatamente li rabbaccerete le Autotra competente.

Smaltimento: non disperdere nell'ambiente.

CONSERVAZIONE: conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente. Proteggere dal calore, dall'esposizione diretta alla luce del sole e dall'umidità.

ENCLAVE

| SIMBOLI | SIGNIFICATO |
|---------|---|
| | Lavaggio a mano. NOTA: normale lavaggio a mano a temperatura massima di 30° con sapone neutro. Risicacquare accuratamente |
| | Non candeggiare |
| | Non asciugare in asciugabiancheria a tamburo rotativo |
| | Non stirare |
| | Non lavare a secco |


ISTRUZIONI PER L'USO

PER LA PRIMA APPLICAZIONE:

INDICAZIONI PER IL MEDICO O TECNICO ORTOPEDICO

1. Rimuovere l'ortesi dall'involucro di plastica, aprire tutti i nastri a strappo delle cinghie e staccare l'imbottitura dalla base.
2. Aprire la chiusura frontale dell'imbottitura.
Chiedere al paziente di inserire il piede e il polpaccio nell'imbottitura (fig. 1).
3. Chiudere la chiusura frontale dell'imbottitura (fig. 2).
4. Chiedere al paziente di posizionare il piede nello scafo del tutore all'interno del guscio.
5. In dotazione ci sono dei comodi cuscinetti in materiale espanso che possono essere spostati per aumentare il comfort oppure rimossi per aumentare l'ampiezza mediolaterale tra le aste (fig. 3).
6. Il nastro a strappo all'interno del guscio aderirà all'imbottitura.
7. Posizionare il pannello frontale (fig. 4).
8. Il pannello frontale se necessario è removibile (fig. 5).
9. Stringere le cinghie dell'avampiede (fig. 6).
10. Stringere le cinghie che fissano il polpaccio al guscio, partendo dalla cinghia più vicina alla caviglia (fig. 7).

Chiedere al paziente di camminare con l'ortesi per accertarsi che essa sia stata applicata e funzioni correttamente.

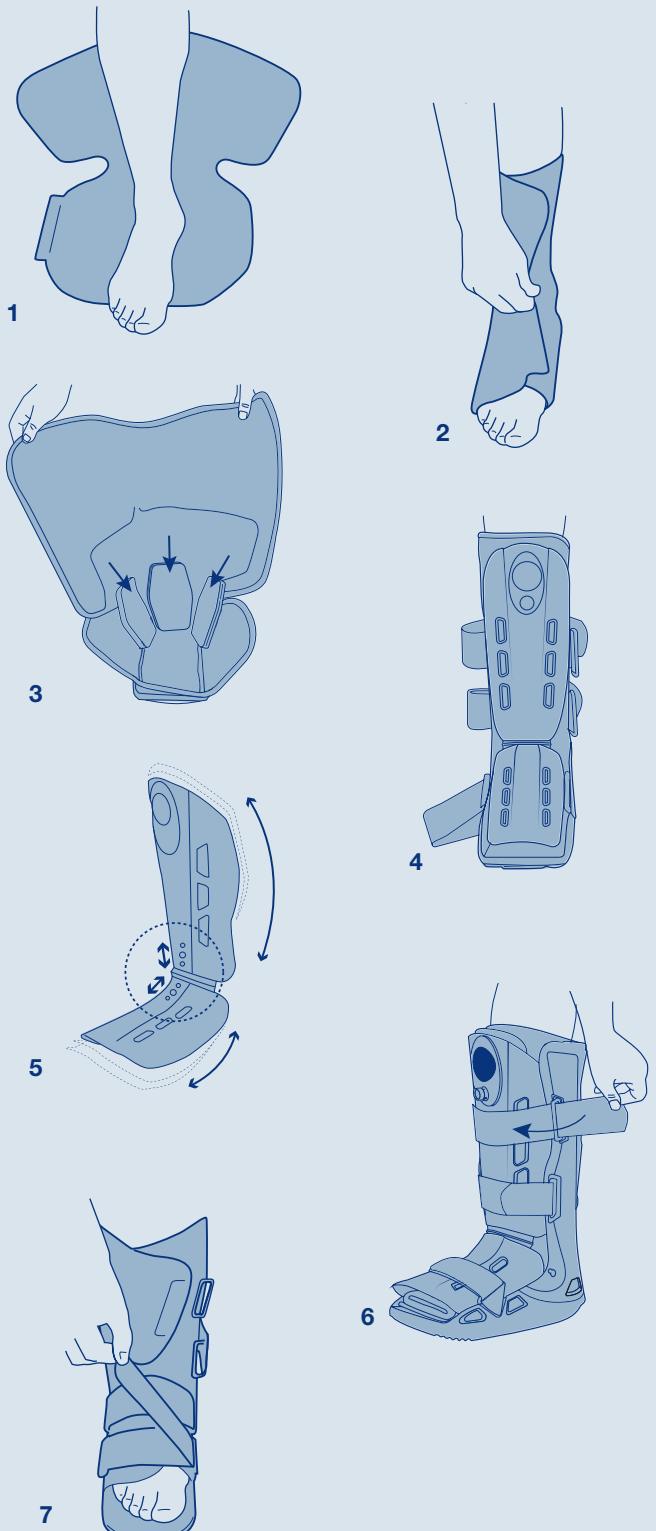

APPLICAZIONI SUCCESSIVE

Se al paziente è consentito rimuovere l'ortesi durante la convalescenza, o se l'ortesi viene rimossa durante una visita medica, è possibile togliere l'ortesi semplicemente aprendo le cinghie e la chiusura frontale della imbottitura. In tal modo, il paziente potrà riapplicare lo stivaletto e l'ortesi con l'adeguato allineamento della gamba.

VERSIONE PNEUMATICA:

Per gonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "INFLATE" fino a chiusura, quindi gonfiare con la pompetta nera (fig. B) fino a quando l'imbottitura risulterà confortevole.

ATTENZIONE: una eccessiva compressione può ridurre la circolazione del sangue.

Per sgonfiare l'imbottitura girare il bottone (fig. A) nella direzione indicata dalla dicitura "DEFLATE" fino a chiusura, l'imbottitura si sgonfia automaticamente, per accelerare lo sgonfiaggio dell'imbottitura premere la pompetta nera.

